

073140VAR1  
SET DE PICCLINE GRIP-LOK

## INDICATION

Nécessaire de soins préconisé lors de la pose ou de la fixation d'un cathéter PICC Line avec dispositif Grip-Lok,

## CARACTÉRISTIQUE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
073140VAR1	Sachet	30	38,8 x 38,7 x 26,9 cm

## CODE GTIN

**GTIN SET :** 3701556401521

**GTIN CARTON :** 3701556401514

## COMPOSITION DU SET

- 1 Charlotte
- 2 Masques type IIR
- 1 Essuie mains
- 1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

**Dans le champ enveloppant :**

- 1 Paire de gants nitrile manchettes retournées taille 7/8 (1er pli)
- 1 Champ patient ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants nitrile manchettes retournées taille 7/8
- 1 Ampoule de NACL 0.9% 20 ml - Classe III
- 1 Aiguille pompeuse 18g
- 1 Seringue Luer lock 20 ml
- 10 Compresses non tissées 7.5 x 7.5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1.25 x 14.8 cm
- 1 Pansement film 10 x 12 cm

**1 Valve bidirectionnelle à pression positive - CLASSE IIa**

**1 pansement Grip-Lok ® - CLASSE Ia**

Innoset assemble des sets composés de différents dispositifs. Conformément au règlement (UE) 2017/745, une notice d'utilisation est obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe IIb et supérieure. Les notices des fabricants, destinées exclusivement aux professionnels de santé, sont regroupées et mises à disposition sous format numérique. Une version papier peut être fournie sur demande.

Date de création du modèle : 14.01.2025 - Version : 03 - FT avec Notice -073140VAR1 - Set de PICCLINE Grip Lok- v03 du 10.12.2025

## STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants  
Ne pas restériliser

## CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.  
Température de stockage entre 15° et 30° C.  
Durée de validité : Voir sur emballage.

## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	<a href="mailto:qualite@innoset.com">qualite@innoset.com</a>

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.

InnoSet assemble des sets composés de différents dispositifs. Conformément au règlement (UE) 2017/745, une notice d'utilisation est obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe IIb et supérieure. Les notices des fabricants, destinées exclusivement aux professionnels de santé, sont regroupées et mises à disposition sous format numérique. Une version papier peut être fournie sur demande.

## DISPOSITIF(S) CONCERNÉ(S)

### 1 AMPOULE DE NACL 0,9 % 20 ML PROTÉGÉE - CLASSE III

**C.D.M. Lavoisier**

*Laboratoires Chaix et Du Marais*

## CHLORURE DE SODIUM Lavoisier 0,9 % STERILE

### ***Solution stérile pour rinçage ou purge de dispositifs médicaux d'accès vasculaire ou rinçage des plaies***

#### 1. Identification du fabricant

<b>Nom du fabricant :</b>	CDM Lavoisier	<b>Lieu de fabrication :</b>	CDM Lavoisier	<b>Siège social :</b>	CDM Lavoisier
		2, allée Henri Hugon		7, rue Pasquier	
		Z.I des Gailletons		75008 PARIS	
		41260 LA CHAUSSE SAINT VICTOR		FRANCE	
		FRANCE			

#### 2. Identification du dispositif

CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE est une solution stérile destinée au rinçage ou à la purge de dispositifs médicaux d'accès vasculaire ou rinçage des plaies.

Ce dispositif médical est présenté : en ampoule bouteille de 10 ou 20 ml, en verre blanc de type I,

#### 3. Indications

CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE, est destiné :

- au rinçage et purge de dispositifs médicaux d'accès vasculaire ;
- au rinçage de plaies.

Ce dispositif médical est compatible avec tous types d'autres dispositifs médicaux dans le cadre de sa destination et de ses indications.

Se référer aux protocoles internes habituels pour la mise en œuvre de ces opérations.

#### Population spécifique

Pour ces indications, il n'y a pas de population spécifique de patients en termes d'âge, de poids ou d'état de santé. L'utilisation prévue de ce dispositif peut inclure le traitement d'enfants, de femmes enceintes ou allaitantes, cependant aucune mesure ou information spécifique additionnelle n'est nécessaire à l'utilisation sûre du dispositif médical chez ces patients.

#### 4. Composition du Dispositif médical

La composition de CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE est la suivante :

Composants	Formule unitaire
Principe actif: Chlorure de sodium	0,9 g
Eau pour préparations injectables q.s.p	100 ml

Ce dispositif médical incorpore la substance médicamenteuse chlorure de sodium à titre accessoire.

#### 5. Bénéfice clinique /performance

##### **Bénéfices attendus dans le cadre de rinçage ou purge de cathéter :**

- Prévenir les risques thrombotiques et infectieux liés à la pose et aux manipulations du cathéter pour abord veineux périphérique ou central.
- Limiter les interactions médicamenteuses quand NaCl 0,9% est utilisé pour le rinçage entre deux solutés.
- Prévenir les extravasations liées à l'administration de cytostatique, par le rinçage de la veine périphérique avec 10 ml de NaCl après et avant chaque administration de ce type de produit.
- Vérifier la perméabilité du système implantable.
- Prévenir l'occlusion du cathéter.

##### **Bénéfices attendus pour le patient dans le cadre de rinçage de plaies :**

- Nettoyer les plaies.

**STERILE**



Les ampoules sont stérilisées à la chaleur humide et ne doivent pas être restérilisées.

**6. Prérequis avant utilisation et instruction d'utilisation**


Ce dispositif médical est destiné à être utilisé par un professionnel de santé (personnel infirmier et autres) en ville ou à l'hôpital. Vérifier la limpideur de la solution avant usage. Afin de prévenir les éventuelles incompatibilités, vérifier l'absence de précipité ou de formation de cristaux.

Utiliser immédiatement après ouverture dans des conditions d'asepsie rigoureuses.

**Instruction d'utilisation :**

L'ouverture des ampoules bouteilles OPC (One Point Cut) est facilitée par l'existence d'un plan de fragilisation au niveau du col repéré par un point coloré.

**Mode d'emploi :** Ouverture de l'ampoule "One Point Cut" (OPC)

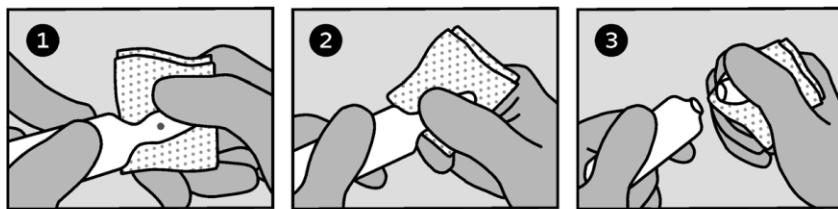

❶ **Saisir l'ampoule** et positionner la compresse entre l'index et la tête de l'ampoule. Le point de couleur dirigé vers soi.

❷ **Placer le pouce sur le point coloré** et appliquer une pression sur l'OPC, vers l'arrière.

❸ L'ampoule est ouverte.

**7. Mise en garde, précautions d'emploi et contre-indications****Mise en garde**

Ne pas utiliser si l'ampoule est endommagée ou si elle est déjà ouverte.

Ne pas utiliser une ampoule au-delà de la date de péremption.

Chez les patients suivant un régime hyposodé strict, prendre en compte qu'une ampoule de 10 ml contient 1,55 mmol (35,7 mg) de sodium, une ampoule de 20 ml contient 3,10 mmol (71,4 mg).

**Précautions d'emploi**

Dans le cas de rinçage ou purge de cathéters, injecter doucement afin d'éviter une surpression.

**Contre-indication**

Ne pas utiliser l'ampoule pour la dilution ou la reconstitution de médicaments.

Le contenu de l'ampoule n'est pas destiné à être injecté directement dans la circulation sanguine.

Ne pas utiliser en cas d'allergie au produit.

**8. Effets secondaires**

CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE, ne présente pas d'effet secondaire. Aucun risque de surdosage n'a été identifié.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente.

**9. Stockage**

CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE ne présente pas de condition particulière de conservation ou d'élimination.

**10. Information à transmettre au patient s'il n'est pas l'utilisateur**

Lorsqu'il est utilisé conformément à ses indications, CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE ne présente pas de risque résiduel, de contre-indication, ou d'effet secondaire indésirable.

**11. Dispositif médical à usage unique**

CHLORURE DE SODIUM LAVOISIER 0,9% STERILE est un dispositif médical à usage unique. Ne pas conserver après usage.



La réutilisation d'une ampoule expose à un risque de contamination.

**12. Version de la notice**

Version N.A(F)/57/G

Date d'apposition du marquage CE : 2010

Dernière révision de la notice : 05/05/2021



—